


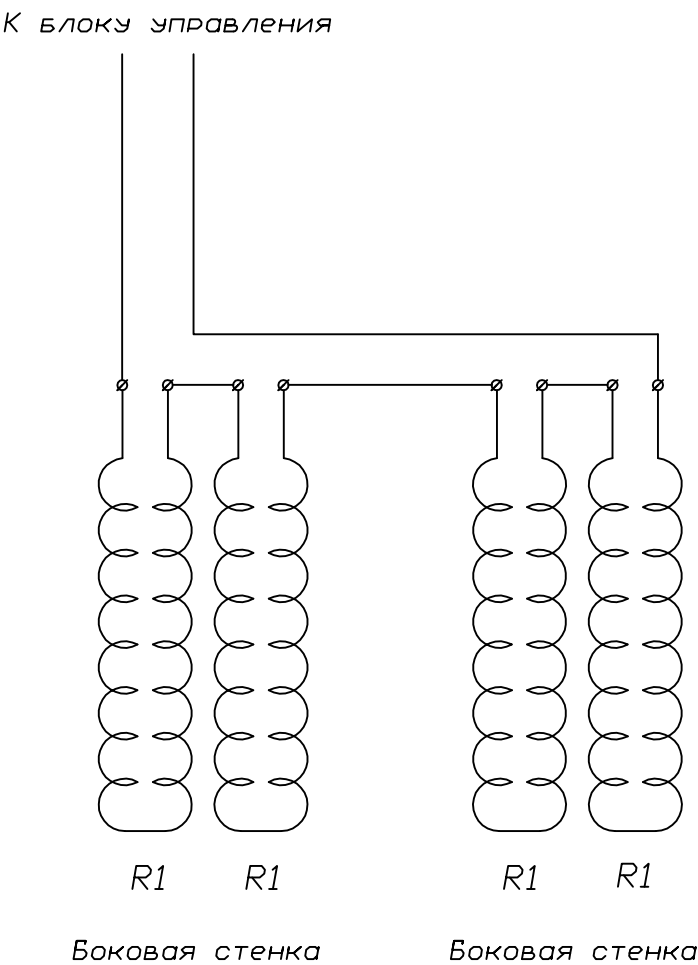

- 1. Данные спирали (P=3кВт): Ст. Суперфехраль GS SY Ø1,5 мм, R1= 4,0 Ом, L1= 4,82м - 4шт;
- 2. Спирали намотаны на оправке обеспечивающей внутренний диаметр после навивки 12⁺¹ мм и размещены на трубке МКРФ диаметром 10/5мм внутри трубки МКР 26/21мм..
- 3. Разводку выполнить термостойким проводом ПВКВ 4мм²

					ПЛ 20/11 – СРН							
Изм.	Лист	# документа	Подпись	Дата	Схема разводки и данные нагревателей			Лист.		Масса	Масшт.	
Разраб.		Трепалин АВ		16.09.10								
Проверил												
Принял		Халабуда										
Ин. тепл.												
					(нагреватели в трубке)			Лист		Листов		
Утв.		Итяксов НН										